



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В центре внимания...



AIS


ПРИГОТОВЬТЕСЬ
К ВЫХОДУ НА РЫНОК НОВОЙ
ВЕРСИИ AIS 3.2!

**ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА НА СИСТЕМАХ X-
MIND Trium: AIS 3.2.1!**

Обновлены имеющиеся и добавлены новые возможности, такие как:

ФИЛЬТР, СНИЖАЮЩИЙ УРОВЕНЬ ПОМЕХ ОТ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ X-MIND PRIME:


Теперь у врача есть возможность работать с использованием MAR фильтра или без него. После получения изображения оператор имеет возможность повторно реконструировать исследование и сравнить результаты с применением MAR фильтра или без него.

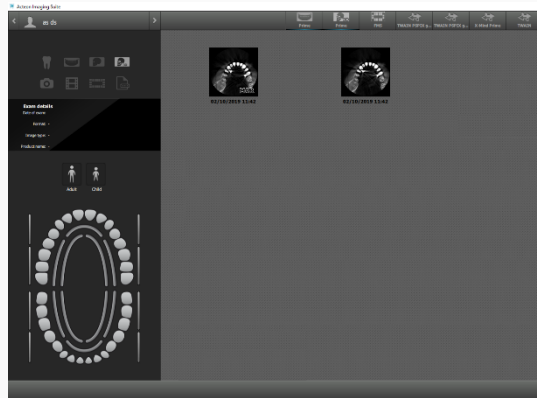

НОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПАНТОМОГРАФИИ И ЦЕФАЛОМЕТРИИ С ПОМОЩЬЮ X-MIND TRIUM 3D PAN SERH:


С новым фильтром для цефалометрии T1, интерпретация результатов исследования станет намного проще:

- Премоляры и резцы лучше визуализируются
- Улучшена дифференциация твердых и мягких тканей
- Антропометрические точки выражены чётче

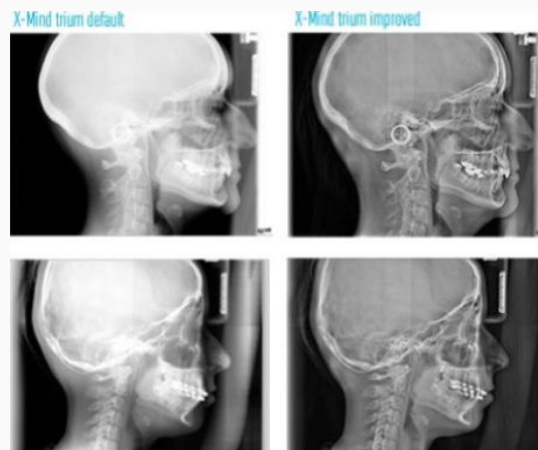

С новым фильтром T1 для пантомографии стоматолог сможет получить:

- Улучшенное общее восприятие изображения
- Более однородное изображение
- Новый уровень детализации и контрастности

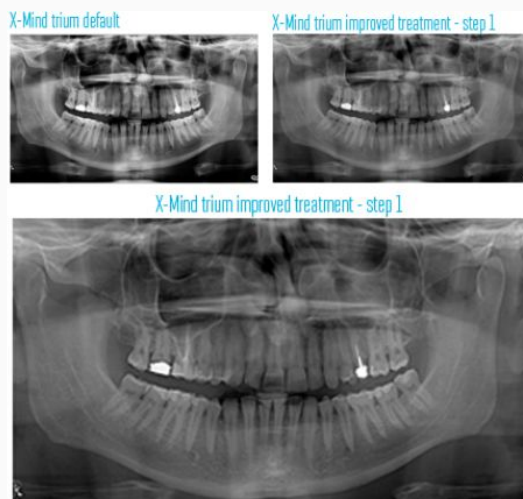

НОВАЯ ВЕРСИЯ ДРАЙВЕРА TRIUM TWAIN:

Драйвер Trium Twain 1.3 позволяет стоматологу одновременно работать с версиями AIS и Twain с помощью собственного программного обеспечения для обработки изображений. Больше нет необходимости закрывать один, чтобы использовать другой!

[Нажмите здесь, чтобы скачать драйвер Twain](#)

[Пора скачать AIS 3.2.1!](#)